


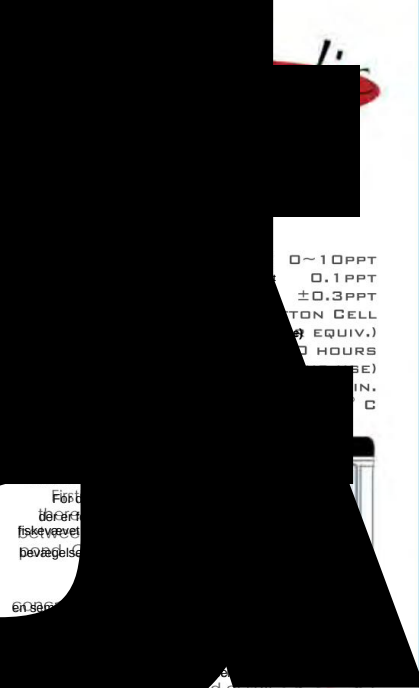

For at opnå de bedste resultater af saltbehandling af fisk, er det vigtigt at sikre, at saltet er korrekt opløst og at fiskene er i et miljø, der understøtter deres helbred. Dette kan gøres ved at bruge KoiMedic, som er et effektivt middel til at bekæmpe sygdomme og parasitter. KoiMedic er et naturligt produkt, der er udviklet af eksperter i koi-opsætning, og det er blevet testet og godkendt af ISO 9001.

***SALT ANVENDELSESGUIDEN**

SG **CE**

TRANS INSTRUMENTS **www.transinstruments.com**

ISO 9001 Certified Firm

Water resistant - floats on water - drop shock - simple to use



TRANS INSTRUMENTS


KoiMedic (healthy Koi always)

for healthy Koi - elimination of parasites - control of algae
Salinity test in % or ppt - Auto End-point - easy salt application

Water resistant - floats on water - drop shock - simple to use

ISO 9001 Certified Firm

Produktfunktion FEATURE

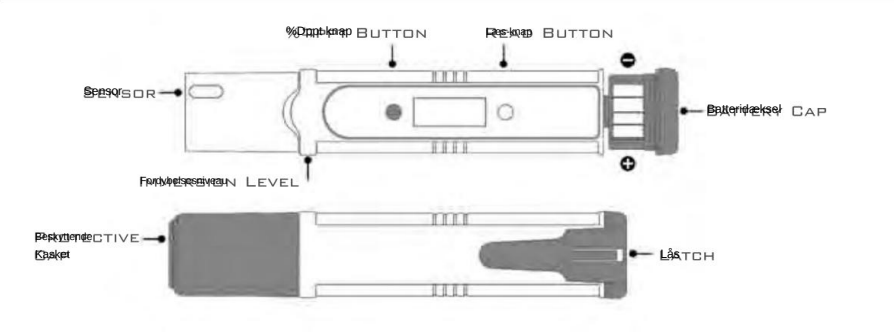

Installation af batteridæksel INSTALLATION

INSTALLER BATTERIDÆKKE

Den lille ladeenhed sættes på batteridækslet. Når den er på plads, vil der være et klik, hvilket betyder, at den er sikker på plads. Dette sikrer, at den ikke falder af, når du bruger enheden.




ADVARSEL: BATTERIER

1. Læs altid anvisningerne om korrekt brug af batterier. **DO NOT PULL** latch out completely.
2. Brug tommelfingeren til at skubbe batteriet ned.
3. Hold batteridækslet fast, og adskil det fra enheden.
4. Udskift alle batterier i henhold til polaritet.



Forholdsregler ved håndtering HANDLING


Rør ikke eller rids ikke sensoren. Den er meget sart og kan knække eller miste sin følsomhed.



Nedsæt ikke enheden under vandet. Selvom enheden er vandtæt, kan den ikke holde under højt tryk under vand. Hvis det sker, skal du straks fjerne den og tørre den grundigt.



Opbevar ikke enheden i beskyttelsesheften eller under høj temperatur og direkte sollys. Dette vil forlænge levetiden og forårsage for tidlig udløb af sensoren.




Rengør ikke enheden med tørt eller opløsningsmidler. Dette vil beskadige enheden. Brug kun et mildt rengøringsmiddel på en fugtig klud til at rengøre og skylle enheden, hvis det er nødvendigt.



KEMISK AL

FORETAGS MÅLING

1. Fjern beskyttelseslæsercap.
2. Tryk én gang på knappen til at sætte den til at læse. Displayet vil blive vist blinkende.
3. Dyp testen ind i prøveopsløsningen op til den næste grønne væskeløsning. For at fjerne bobler: Små bobler på sensoren vil påvirke nøjagtigheden og vil affect accuracy.
4. Hold dyb stille og vent på, at læsning af Nær displayet holder op med at blinke og blikker igen og etablerer en stabil læsning. Du kan nu tage læsningen. (You can now take the reading.
5. Tryk på knappen til at sætte igen for at foretage en ny læsning. Når displayet blinker, betyder det, at den heden registrerer, en stabil læsning og vent på, at en komplet temperaturkompensation finder sted. for a complete temperature compensation to take place.
6. Hvis målingen foretages i en krog, skal du sørge for at efterlade et mellemrum på 12 tommers eller 3 cm mellem bunden og bottom.
7. Skyd altid sensoren i bæltet med rent postevand før og efter hver test. Blev det i bløddet i krogen postevand i mindst 30 minutter før opbevaring fore storing.
8. For ån slukke skal du trykke på og holde læseskappen nede i 3 sekunder.
9. Udskift med beskyttelseslæsercap, før den opbevares i en krog.

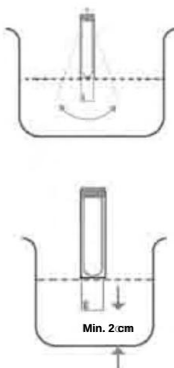

Innerværelse af visse radiosendere kan dette produkt producere fejlagtige aflæsninger. Hvis dette sker, skal målingerne gentages et andet sted. *Should be repeated at another location.*

VEDLIGEHOJDELSE

Hvis anlægsningerne er lovligt, bør du bede din forhandler om at ordre en kalibrering, eller du kan gøre det selv.

REMARK: VIDEO FOR AID RIG/KAN BRERENG HVIS DU IKKE HAR SS0005 STANDARD LØSUNG

FORKERT KALIBRERING VIL HÆT PÅ VIRKNING AF NØJAGTIGHED

1. Sørger til, du har den korrekte standardoplysning indtastet 0,50% eller 5,0pp. Standardoplysning standard solution.
2. Omdrej sensoren i oplysninglinjen, mens du holder et mellemrum mellem bunden af sensoren og displayet.
Omdrej sensoren i oplysninglinjen, mens du holder et mellemrum mellem bunden af sensoren og displayet.
Turn the sensor in the display line, while you hold a space between the bottom of the sensor and the display.
3. Tænder til enheden, og tryk derefter på og hold lådestreket i knappen på 3 sekunder. Knappen lyser, indtil displayet viser CAL.
Turn the device on, and then press and hold the power button for 3 seconds. The button lights up until the display shows CAL.
Turn on the device, and then press and hold the power button for 3 seconds. The button lights up until the display shows CAL.
4. og tryk. Derefter vises 0,50% eller 5,0pp i en blinkende tilstand.
and press. Then 0.50% or 5.0pp appears in a blinking mode.
and press. Then 0.50% or 5.0pp appears in a blinking mode.
5. Hold dig stille og vent, indtil den blipper, og displayet holder op med at blink.
Stand still and wait until it blinks, and the display stops blinking.
Stand still and wait until it blinks, and the display stops blinking.
6. Kvalitetskontrol. Sæt SKJ-1 sensoren i et rent glas med destilleret vand, før du går videre.
Quality control. Put SKJ-1 sensor in a clean glass with distilled water, before proceeding with further tests.
Quality control. Put SKJ-1 sensor in a clean glass with distilled water, before proceeding with further tests.

FEDL KODER:

1. Hvis EDC vises under kalibrering, betyder det, at du sandsynligvis har brugt en defekt eller fejldiagnostiseret standardløsning. wrong standard solutions.
 1. Hvis EDC vises under kalibrering, betyder det, at du sandsynligvis har brugt en defekt eller fejldiagnostiseret standardløsning. wrong standard solutions.
2. Hvis EDC vises under kalibrering, betyder det, at enheden ikke kan få en stabil aflæsning. Dette kan nogle gange skyldes et jordmagnetisk interferens, hvis du bruger enheden i nærheden af et højteknologisk udstyr eller områder med høj stærkt magnetfelt. For at forhindre dette skal du flytte til et andet sted længere væk. Andre årsager kan skyldes en defekt sensor. Enhed med en defekt sensor kan ikke repareres. due to a defective sensor. Unit with a defective sensor cannot be repaired.
3. Når du trykker på en af de kalibreringsknapper, hører du en klirrende lyd. calibration mode.

ALARM FOR LAVT

BATTERI Når batterisymbolet vises på displayet, indikerer det, et lavt batteri og der er kun 2 timers kontinuerlig brug af tilbageladelse. Selvom enheden kan fortsætte med at fungere, vil enhedens nøjagtighed blive påvirket ud over 2 timer be affected beyond 2 hours.

Odskift batterierne i henhold til instruktionerne på næste side af

indstilling af enheder og noter & NOTES

SWIFTNING AF MÅLENEHEDERTIL PPT 1 De me

enheter i tabrikssulfid per tygsmått procent (%). Du kan insläta den giat (mål) i dele pr. tusinde (pptl).

2. Tryk og hold på ppt-knappen nede, indtil denipper. Den høje side af displayet vil vise ppt/hviletid (køretid/måling) ppt/tryk og hold knappen nede igen for at skifte de målte enheder tilbage til % ppt-regner for sig selv, hvilket indikerer måling i % (red units back to %). The ppt sign will disappear, indicating measurement in %.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

Brug ikke kodesalt. Brug kun ikke-koderet salt. Ved første bands

Saltpatrøjer er den vigtige hjælpemiddel, der giver tid til at gendanne den biologiske balance i din tarm. Tilsæt salt over en periode på flere dage eller endda over flere måneder til dine sunde bakterier for at hjælpe dem med at gendanne den biologiske balance.

▪ Pådr ikke salt direkte i tarmen. Enhver direkte kontakt af krystallinsk salt med Koi eller fisk på få sekunder kan forårsage skader, der ligner fortørrelser.

Opbejldet sættes i en spand med vand og først og fremmest på udløssiden af biofilteret for
 lille dam og jævnt rundt om kanterne for større dam.

For ikke at choke i køen, er det altid bedre at opdele påringtonen i en lille delvis påsætning over 3 dage (tre) for alt på én gang, one time.

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF SALT

Dette er kun en referencevejledning. Kontakt venligst kol-specialisten for mere rådgivning.

What is the ideal salt concentration for dammen? pond?

Det ansees at opptredende salikkoncentrasjoner omkrirg 0,13% til 0,25% (1,3 til 2,5 ppt) i dammen pond.

Saltkoncentrationer mellem 0,3% og 0,5% (3 til 5 g pr. l) forstørre den osmotiske balance hos nogle parasitter, dvs. parasiternes cellevæ-
dendrydere og dermed dræbe dem. Saltkoncentration på 0,3% er effektivt bl.a. agtrent og er blevet brugt til at kontrollere strengalger.
Ikke desto mindre kan 0,3% salt også hæmme akander og nydelplanter (vandskab, varsløse osv.) 2% af fleste mosseplanter, water
lilies and floating plants (water hyacinth, water lettuce, etc.) than most bog plants.

Frå behandling af parasitter og karantæne anbefales det at behandle koi'en separat i tank eller hospitalstank. Et forlænget højt saltniveau i hele dammen vil fremme parternes af superparasitter, der vil blive immun over for højere saltniveau. Det er vigtigt ikke at forlænge saltniveauet over 0,25 iF mere end 2 uger. Forlæng dam til 0,15 iF (0,2 iF) more than 2 weeks. Dilute pond to

Kødt dammen på 0,1 % til 0,2 % saltvands- og brug parasitcider eller antibiotika, der indføres samtidig med behandlingen. Denne behandling er til forebyggelse og konsultationer påkrævet fra din lokale købervariser for specifikke infektioner, cal koi suppler for specifikke infektioner.

What is the amount of salt per kg of soil in the sand?

For første gang bør tilsætning af 11 m³ 2 pund (0,8 til 1 kg) salt (pr. 5-100 gallons (500 liter) vand) være tilstrækkelig.

Control Reading: 1.3ppt til 2.5ppt. 0.13% til 0.25% 1.3ppt to 2.5ppt.

For at afgjøre nitritlevel og kontrollere alger, er det bedst at bruge 2 ml (3 pund (1 til 1,5 kg) pr. 100 gallons (500 liter) vand for at reducere nitratkoncentrationen, to reducere nitrite toxicitet.

Control Reading: 0.25% to 0.37%

What is the amount of salt, der skal tilsættes til en karantænetank?

Opsætningen af en karantænetank er vigtig for at forhindre et udbrud, når du introducerer nye fisk eller for at adskille syge fisk fra din dam.
Du skal sætte ny fisk i karantæne i 1 uge for at sikre, at den ikke bærer nogen sygdom eller parasitter.
week to ensure it is not carrying any disease or parasites.

Andet 2 til 4 pounds (1 kg til 2 kg) salt pr. 100 gallons (500 liter) til 1 mg (medicin som anbefalet af leverandøren til hospitalstank) supplied by the supplier for hospital tank.

Control Reading: 0.5% to 0.55% 5ppt to 5.5ppt